



# HiSelect Ni HF

## 目录

|              |   |
|--------------|---|
| 1. 产品介绍      | 1 |
| 2. 纯化流程      | 2 |
| 3. 在位清洗      | 4 |
| 4. 填料再生      | 4 |
| 5. 问题及解决方案   | 4 |
| 6. 订购信息及相关产品 | 5 |

## 1. 产品介绍

**Ni NTA Beads HF** 是一种新型固定化金属离子亲和层析 (IMAC) 介质，整合有非常牢固的 Ni 离子（产品结构见图 1 所示），具体性能见表 1。**Ni NTA Beads HF** 是高刚性的琼脂糖微球基质，较传统工艺可以耐受更高的流速并提供更高的化学稳定性，广泛用于生物制药和生物工程下游蛋白质和多肽的分离纯化。

**HiSelect Ni HF** 是一种中压预装柱，填充 4.7 ml 的 **Ni NTA Beads HF** 介质。柱管由生物相容性聚丙烯制成，不与生物分子相互作用。柱管两头都有堵头，防止保护液的泄露。柱体标签上的箭头表示推荐的流向。预装柱具有标准接口，可以适配商品化的各类中压色谱系统，如 ÄKTA 等，方便客户操作。

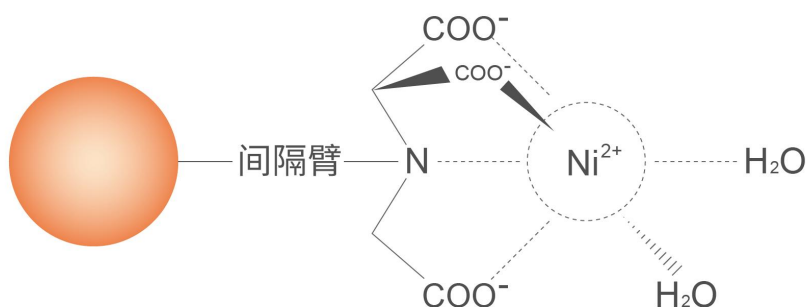


图 1. Ni NTA Beads HF 化学结构示意图

表 1. HiSelect Ni HF 产品性能

| 项目          | 性能                                         |
|-------------|--------------------------------------------|
| 基质          | 高流速琼脂糖微球                                   |
| 离子载量        | 20-30 $\mu\text{mol Ni}^{2+}/\text{ml}$ 介质 |
| 微球粒径        | 85-95 $\mu\text{m}$                        |
| 最大压力        | 0.3 MPa, 3 bar                             |
| 流速*         | $\leq 600 \text{ cm/h}$                    |
| 储存缓冲液       | 20%乙醇 (2%苯甲醇可选)                            |
| 储存温度        | 2-8°C                                      |
| 柱尺寸 (内径×高度) | 0.77×10 cm                                 |

\*: 层析柱 50×500 mm, 柱高 25 cm, 25°C 去离子水在 0.3 MPa 时的线性流速。

表 2. HiSelect Ni HF 试剂耐受情况

| 试剂种类 | 浓度                             |
|------|--------------------------------|
| 还原剂  | 5mM DTE                        |
|      | 1mM DTT                        |
|      | 20 mM $\beta$ -mercaptoethanol |
|      | 5 mM TCEP                      |
|      | 10 mM reduced glutathione      |
| 变性剂  | 8 M urea                       |
|      | 6 M Gua-HCl                    |





表 2. HiSelect Ni HF 试剂耐受情况 (续表)

| 试剂种类 | 浓度                                     |
|------|----------------------------------------|
| 去污剂  | 2% Triton™ X-100 (nonionic)            |
|      | 2% Tween™ 20 (nonionic)                |
|      | 2% NP-40 (nonionic)                    |
|      | 2% Cholate (anionic)                   |
|      | 1% CHAPS (zwitterionic)                |
| 其他类  | 500 mM imidazole                       |
|      | 20% ethanol                            |
|      | 50% glycerol                           |
|      | 100 mM Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> |
|      | 1.5 M NaCl                             |
|      | 1 mM EDTA                              |
|      | 60 mM citrate                          |

注：如果溶液中含有上述两种以上的试剂，介质的耐受性能可能会进一步下降

## 2. 纯化流程

### 2.1 缓冲液的准备

可使用下列推荐缓冲液，也可根据自己的使用习惯配置不同的缓冲液体系，基本原理就是低咪唑上样，高咪唑洗脱，或者高 pH 上样，低 pH 洗脱。缓冲液在使用前最好用 0.22 μm 或者 0.45 μm 滤膜过滤。因为 HiSelect Ni HF 可以用于可溶蛋白和包涵体蛋白的纯化，两种方法所需缓冲液不同。具体配置方法见表 3、表 4 和表 5。

表 3. 可溶性组氨酸标签蛋白纯化所需缓冲液及配方

| 名称             | 体积  | 配方                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lysis Buffer   | 1 L | 50 mM NaH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> (7.80 g NaH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> ·2H <sub>2</sub> O)<br>300 mM NaCl (17.54 g NaCl)<br>10 mM imidazole (0.68 g imidazole)<br>使用 NaOH 溶液调节 pH 至 8.0，使用 0.22 或者 0.45 μm 滤膜过滤。  |
| Wash Buffer    | 1 L | 50 mM NaH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> (7.80 g NaH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> ·2H <sub>2</sub> O)<br>300 mM NaCl (17.54 g NaCl)<br>20 mM imidazole (1.36 g imidazole)<br>使用 NaOH 溶液调节 pH 至 8.0，使用 0.22 或者 0.45 μm 滤膜过滤。  |
| Elution Buffer | 1 L | 50 mM NaH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> (7.80 g NaH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> ·2H <sub>2</sub> O)<br>300 mM NaCl (17.54 g NaCl)<br>250 mM imidazole (17.0 g imidazole)<br>使用 NaOH 溶液调节 pH 至 8.0，使用 0.22 或者 0.45 μm 滤膜过滤。 |

表 4. 包涵体组氨酸标签蛋白纯化所需缓冲液及配方，pH 洗脱方式

| 名称             | 体积  | 配方                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lysis Buffer   | 1 L | 8 M Urea (480.50 g urea)<br>100 mM NaH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> (15.60 g NaH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> ·2H <sub>2</sub> O)<br>100 mM Tris·HCl (15.76 g Tris·HCl)<br>使用 HCl 溶液调节 pH 至 8.0，使用 0.22 或者 0.45 μm 滤膜过滤。 |
| Wash Buffer    | 1 L | 8 M Urea (480.50 g urea)<br>100 mM NaH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> (15.60 g NaH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> ·2H <sub>2</sub> O)<br>100 mM Tris·HCl (15.76 g Tris·HCl)<br>使用 HCl 溶液调节 pH 至 6.3，使用 0.22 或者 0.45 μm 滤膜过滤。 |
| Elution Buffer | 1 L | 8 M Urea (480.50 g urea)<br>100 mM NaH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> (15.60 g NaH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> ·2H <sub>2</sub> O)<br>100 mM Tris·HCl (15.76 g Tris·HCl)<br>使用 HCl 溶液调节 pH 至 4.5，使用 0.22 或者 0.45 μm 滤膜过滤。 |





表 5. 包涵体组氨酸标签蛋白纯化所需缓冲液及配方，咪唑洗脱方式

| 名称             | 体积  | 配方                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lysis Buffer   | 1 L | 8 M Urea (480.50 g urea)<br>50 mM NaH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> (7.80 g NaH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> ·2H <sub>2</sub> O)<br>300 mM NaCl (17.54 g NaCl)<br>10 mM imidazole (0.68 g imidazole)<br>使用 NaOH 溶液调节 pH 至 8.0, 使用 0.22 或者 0.45 μm 滤膜过滤。  |
| Wash Buffer    | 1 L | 8 M Urea (480.50 g urea)<br>50 mM NaH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> (7.80 g NaH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> ·2H <sub>2</sub> O)<br>300 mM NaCl (17.54 g NaCl)<br>20 mM imidazole (1.36 g imidazole)<br>使用 NaOH 溶液调节 pH 至 8.0, 使用 0.22 或者 0.45 μm 滤膜过滤。  |
| Elution Buffer | 1 L | 8 M Urea (480.50 g urea)<br>50 mM NaH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> (7.80 g NaH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> ·2H <sub>2</sub> O)<br>300 mM NaCl (17.54 g NaCl)<br>250 mM imidazole (17.0 g imidazole)<br>使用 NaOH 溶液调节 pH 至 8.0, 使用 0.22 或者 0.45 μm 滤膜过滤。 |

## 2.2 样品准备

### 2.2.1 细菌或酵母表达的蛋白

- 1) 挑取单菌落到培养基中，根据载体使用说明，加入相应浓度的诱导剂诱导相应的时间。
- 2) 表达结束后，将培养液转移到离心杯中，7,000 rpm (7,500×g)，离心 15 min 收集菌体，然后按照菌体：Lysis Buffer=1: 10 (W/V) 加入 Lysis Buffer，加入终浓度为 1 mM 的 PMSF。加入溶菌酶（工作浓度为 0.2-0.4 mg/ml，如果表达的宿主细胞内含 pLysS 或 pLysE，可以不加溶菌酶），（同时也可加入其他蛋白酶抑制剂，但不能影响目的蛋白与介质的结合）。
- 3) 将菌体沉淀悬浮起来（如果菌液浓度高，也可考虑加入 10 μg/ml RNase A 和 5 μg/ml DNase I），混匀，放置于冰上，然后冰上超声破碎细胞，至菌液基本保持澄清。
- 4) 将澄清的破碎液转移至离心管中，10,000 rpm (15,000×g)，4℃离心 20-30 min。取上清，置于冰上备用或-20℃保存。

### 2.2.2 酵母、昆虫和哺乳细胞分泌表达可溶性蛋白

- 1) 将细胞培养液转移至离心杯，5,000 rpm (3,800×g)，离心 10 min，收集菌体得上清，如上清中不含 EDTA、组氨酸和还原剂等物质，即可直接加入柱子使用；如含有 EDTA、组氨酸和还原剂等物质，需用 Lysis Buffer 透析后才能加入柱子。
- 2) 对于大量体积的上清，需加入硫酸铵沉淀浓缩后，蛋白还需用 Lysis Buffer 透析后才能加入柱子。

### 2.2.3 包涵体蛋白纯化（变性条件）

- 1) 将培养液转移到离心杯中，7,000 rpm (7,500×g)，离心 15 min 收集菌体，去掉上清。
- 2) 按照菌体：Lysis buffer（不含 8M 尿素）=1:10 (W/V) 将菌体悬浮起来混匀，冰浴超声破碎。
- 3) 将破碎液转移至离心管中，10,000 rpm (15,000×g)，4℃离心 20-30 min。去掉上清，步骤 2 和 3 可以重复一次。
- 4) 按照菌体：Lysis buffer（含 8M 尿素）=1:10 (W/V) 将包涵体悬浮起来。
- 5) 变性条件下进行 His 标签蛋白纯化，具体缓冲液配方见表 4、表 5。

## 2.3 样品纯化

HiSelect Ni HF 是一种用于组氨酸标签蛋白纯化的预装柱产品，可以用各种常规的中低压色谱系统。

- 1) 将泵管道中注满去离子水。去掉上塞子，将层析柱连接至色谱系统中。再打开下口，将预装柱接到色谱系统中，并旋紧。
- 2) 用 3-5 倍柱体积的去离子水冲洗出存储缓冲液。
- 3) 使用至少 5 倍柱床体积的 Lysis Buffer 平衡色谱柱。
- 4) 利用样品泵或样品环上样。

注：样品的粘度增加使得即使上样体积很少，也会导致层析柱很大的反压。上样量不要超过柱子的结合能力。大量的样品体积也可能造成很大的反压，使得进样器更难使用。

- 5) 用 Wash Buffer 冲洗柱子，直到紫外吸收达到一个稳定的基线（一般至少 10-15 个柱体积）。注：在样品和结合缓冲液中加入咪唑可以提高样品纯度。

- 6) 用 Elution Buffer 采用一步洗脱或线性梯度洗脱。一步洗脱中，通常 5 倍柱体积洗脱液就足够了。可以用一个小的梯度，例如 20 倍柱体积或更多，来分离不同结合强度的蛋白质。

- 7) 依次使用 3 倍柱体积的 Lysis Buffer 和 5 倍柱体积的去离子水平衡填料，最后再用 5 倍柱体积的储存缓冲液平衡，然后保存在 20% 的储存缓冲液中，置于 2-8℃，防止填料被细菌污染。





## 2.4 SDS-PAGE 检测

将使用纯化产品得到的样品（包括流出组分、洗杂组分和洗脱组分）以及原始样品使用 SDS-PAGE 检测纯化效果。

## 3. 在位清洗

当填料使用过程中发现反压过高或者填料上面出现明显的污染时，需要进行在位清洗操作（Cleaning-in-Place, CIP）。建议按照下面操作去除填料上残留的污染物，如沉淀蛋白、疏水蛋白和脂蛋白等。

### 去除强疏水结合的蛋白，脂蛋白和脂类

通过使用 30% 异丙醇清洗 5-10 个柱体积，接触时间为 15-20 min 可以去除此类污染物。然后，再使用 10 倍柱体积的去离子水清洗。也可以选择使用含有去污剂的酸性或碱性溶液，清洗填料 2 倍柱体积。例如，含有 0.1-0.5% 非离子去污剂的 0.1 M 醋酸溶液，接触时间为 1-2 h。去污剂处理后，需要使用 70% 的乙醇清洗 5 个柱体积，以彻底去除去污剂。最后使用 10 倍柱体积的去离子水清洗。

### 去除离子作用结合的蛋白

使用 1.5 M NaCl 溶液清洗 10-15 min。然后，再使用去离子水清洗 10 个柱体积。

## 4. 填料再生

组氨酸标签蛋白亲和纯化填料所带的镍离子不需要经常螯合去除和重新挂镍离子。当填料使用过程中发现颜色变浅，或者填料载量明显变低时，需要进行对填料进行镍离子剥离和重新挂镍离子，也就是填料再生。将填料装填在合适的层析柱内，按照下面操作流程进行镍离子剥离和重新挂镍离子。

- 1) 使用 5 倍柱体积去离子水清洗填料；
- 2) 使用 5 倍柱体积 100 mM EDTA (pH 8.0) 剥落镍离子；
- 3) 使用 10 倍柱体积去离子水清洗填料；
- 4) 使用 0.5 M NaOH 清洗 5 倍柱体积，停留 10-15 min；
- 5) 使用 10 倍柱体积去离子水清洗填料；
- 6) 使用 3-5 倍柱体积 100 mM NiSO<sub>4</sub> 再生挂镍；
- 7) 使用 10 倍柱体积去离子水清洗；

填料再生后，可以立即使用，如不立即使用，需要将填料悬浮于等体积的储存缓冲液中，置于 2-8℃ 保存。

## 5. 问题及解决方案

| 问题          | 原因分析                 | 推荐解决方案                                                                                         |
|-------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 柱子反压过高      | 填料被堵塞                | 按照第 3 部分对填料进行在位清洗。<br>裂解液中含有微小的固体颗粒，建议上柱前使用滤膜（0.22 或 0.45 μm）过滤，或者离心去除。                        |
|             | 样品太粘稠                | 样品中含有高浓度的核酸，加长破碎时间直至粘度降低，或者添加 DNase I（终浓度 5 μg/ml），Mg <sup>2+</sup> （终浓度 1 mM），冰上孵育 10-15 min。 |
|             | 缓冲液太粘稠               | 有机溶剂或者蛋白稳定试剂（如甘油等）可能会引起反压增高，降低操作流速。                                                            |
| 洗脱组分中没有目的蛋白 | 蛋白可能是包涵体，没有在上清中      | 可以通过电泳检测裂解液分析上清中是否含有目的蛋白，包涵体蛋白需要按照包涵体蛋白的纯化方式。                                                  |
|             | 表达量太低                | 优化表达条件，使用包涵体纯化缓冲体系。                                                                            |
|             | 目的蛋白结合比较弱，在洗杂步骤被洗下来了 | 提高 Wash Buffer 的 pH，或者降低咪唑浓度。                                                                  |
|             | 目的蛋白结合过强，不容易洗脱下来     | 降低 Elution Buffer 的 pH 值，或者增加 Elution Buffer 中咪唑浓度。<br>使用 10-100 mM EDTA 溶液剥离镍离子，同时得到目的蛋白。     |
|             | 蛋白降解                 | 在 4℃ 下进行纯化操作。<br>菌体破碎时添加一些蛋白酶抑制剂。                                                              |





|                |                 |                                                         |
|----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|
| 洗脱组分不纯（含有多重蛋白） | 洗杂操作不彻底         | 增加 Wash Buffer 体积。                                      |
|                | 样品中含有其他的组氨酸标签蛋白 | 通过调节 pH 值，或者咪唑浓度来优化洗杂条件。再使用其他的纯化手段（如离子交换，疏水等）进一步纯化洗脱组分。 |
| 填料颜色变浅或变成白色    | 镍离子脱落或被剥离       | 按照第 4 部分填料再生中的建议重新挂镍离子。                                 |
| 填料呈现褐色         | 缓冲液中含有还原剂       | 参考表 2，适当降低还原剂的浓度，或者改用β-巯基乙醇。                            |
| 上样过程中蛋白发生沉淀    | 操作温度太高          | 4℃下进行上样。                                                |
|                | 蛋白发生聚集          | 在样品和所有的缓冲液中添加稳定剂，如 0.1% 的 Triton X-100 或者 Tween-20。     |

## 6. 订购信息及相关产品

| 名称             | 货号       | 规格       |
|----------------|----------|----------|
| HiSelect Ni HF | SA101C47 | 1×4.7 ml |
| HiPur Ni HF    | SA101C20 | 1×20 ml  |

